


SPOKEY

www.spokey.eu

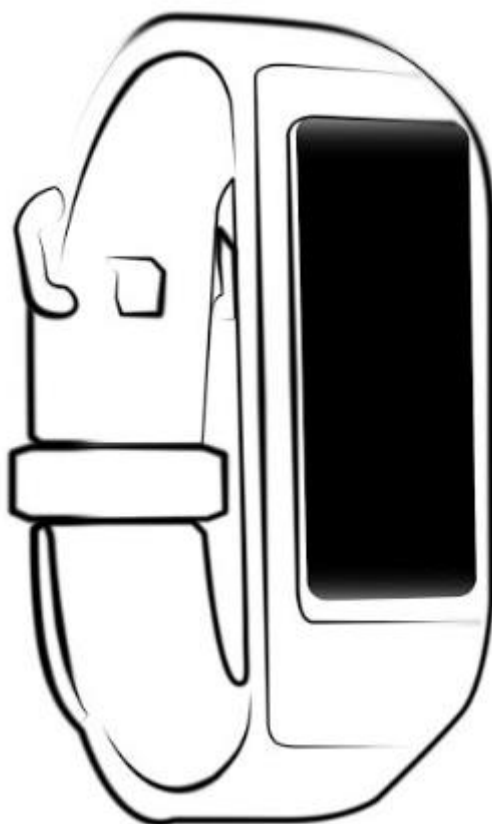


MODEL: SMARTBAND

SCHEMAT / DIAGRAM / CXEMA / SCHÉMA / SCHEMA / SHĚMA	1
(PL)	5
(EN)	7
(RU)	9
(CZ)	11
(SK)	13
(LT)	15
(LV)	17
(DE)	19


Specyfikacje tego produktu mogą się nieco różnić od ilustracji, bądź ulec zmianie. / The specifications of this product may slightly differ from the illustrations or may be modified. / Спецификации данного изделия могут несколько отличаться от иллюстраций или в них могут быть внесены изменения. / Specifikace tohoto produktu se mohou lišit od ilustrace nebo mohou být změněny. / Špecifikácia tohto produktu sa môže minimálne líšiť od uvedenej na obrázku alebo podľahnúť úpravám / Šio produkto specifikacijos gali šiek tiek skirtis nuo parodytu, arba pasikeisti. / Šī produkta specifikācijas var mazliet atšķirties no šeit parādītajām, vai mainīties. / Die Eigenschaften des Produkts können von den Abbildungen abweichen oder einer Änderung unterliegen.

SCHEMAT | DIAGRAM | CXEMA | SCHEMA | SCHEMA | SHÉMA | SCHEMA

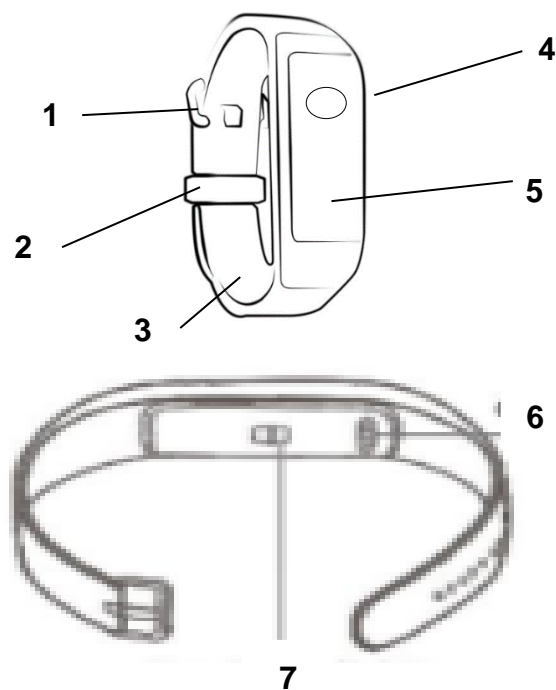



	PL	EN	RU	CZ	SK	LT	LV	DE
1	Zatrask	Clasp	Защелка	Spona	Spona	Segtukas	Sprādze	Verschluss
2	Oczko od paska	Strap ring	Шлейка ремешка	Tah na řemínku	Ťah na řemienku	Dirželio akutę	Siksnas cilpa	Gürtelring
3	Pasek	Watchband	Браслет	Řemínek	Remienok	Dirželis	Siksna	Armband
4	Przycisk dotykowy	Touch screen	Сенсорная кнопка	Dotykové tlačítka	Dotykové tlačidla	Jutiklinis mygtukas	Skārienjutīgs taustiņš	Drucktaste
5	Wyświetlacz	Screen	Экран	Displej	Displej	Ekranas	Ekrāns	Display
6	Punkt kontaktowy ładowania	Charging Contact Point	Контактное гнездо зарядки	Kontaktní bod nabíjení	Kontaktný bod nabíjania	Įkrovimo lizdas	Lādēšanas saskares punkts	Ladungspunkt
7	Czujniki wykrywające tętno	Heart Rate lights	Индикаторы сердечного ритма	Senzory tepové frekvence	Senzory tepovej frekvencie	Pulsą rodanti lemputė	Pulsa indikatorī	Herzfrequenz-Dioden

JAK ŁADOWAĆ | HOW TO CHARGE | КАК ЗАРЯДИТЬ | JAK PŘÍSTROJ NABÍJET | AKO PRÍSTROJ NABÍJAŤ | SĚDYNĚS REGULIAVIMAS | SĚDEKĻA REGULĒŠANA | EINSTELLUNG SATTEL

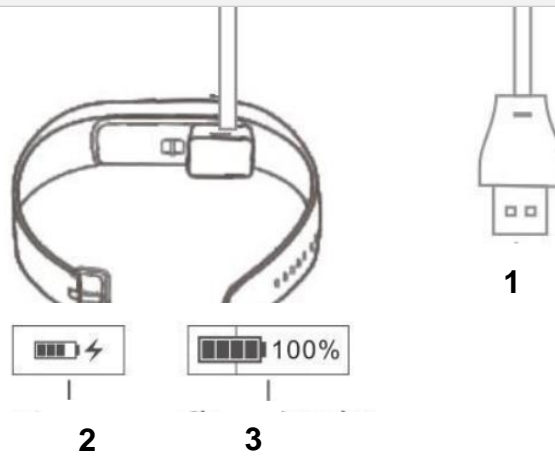


Pobierz aplikację Gfit | Download Gfit app / Скачать приложение Gfit / Stáhněte si aplikaci Gfit / Stiahnite si aplikáciu Gfit
Atsisiųsti „Gfit“ taikomąją program / Lejupielādējiet aplikāciju Gfit / Herunterladen Sie die Gfit Applikation

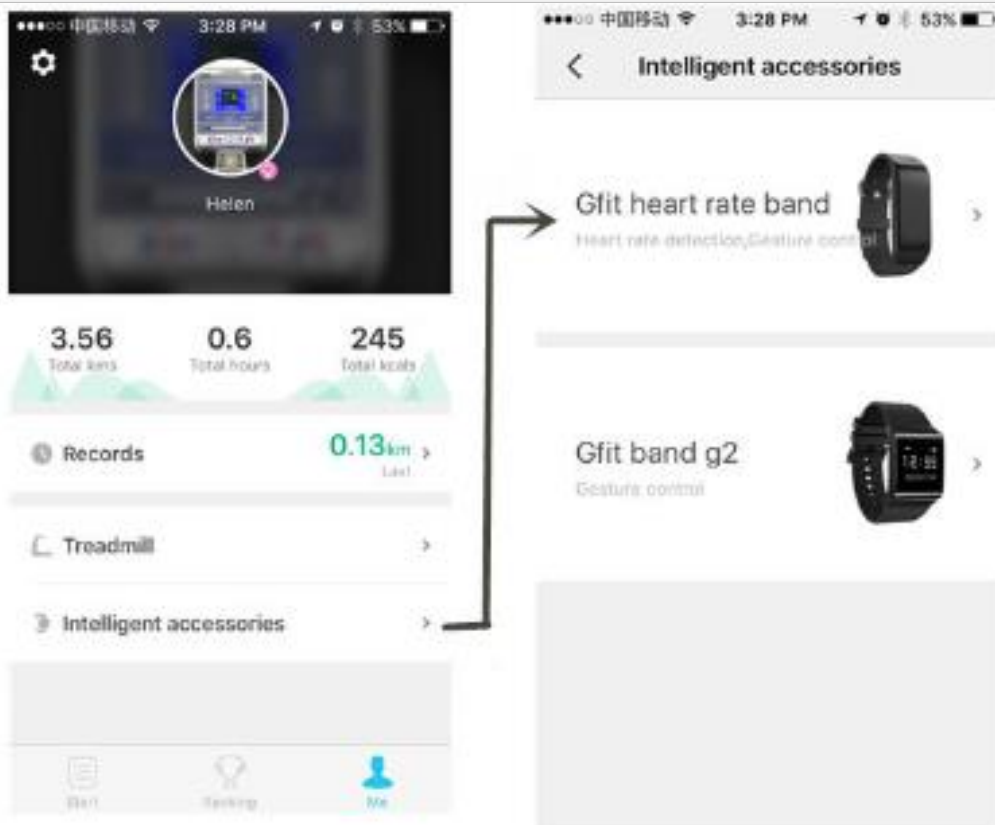

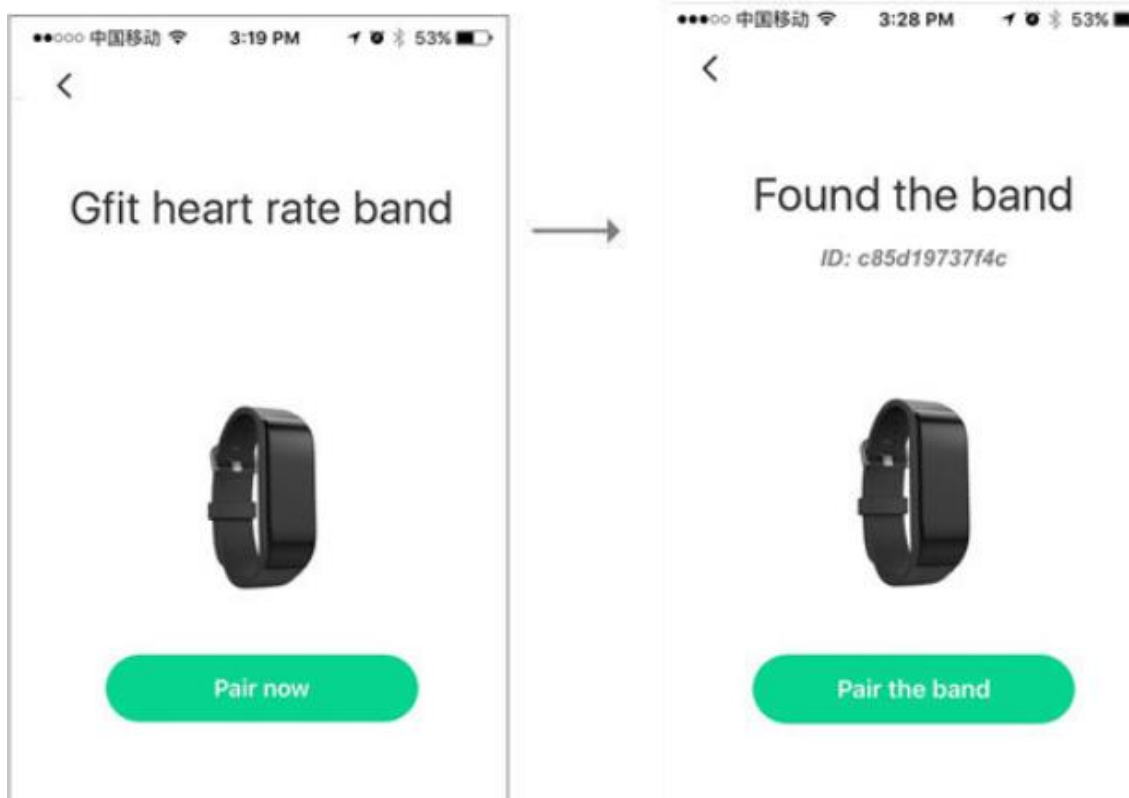

FUNKCJE | FUNCTION INSTRUCTION | ИНСТРУКЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | FUNKCE | FUNKCIE | NAUDOJIMO INSTRUKCIJA FUNKCIJU INSTRUKCIJA / FUNKTIONEN

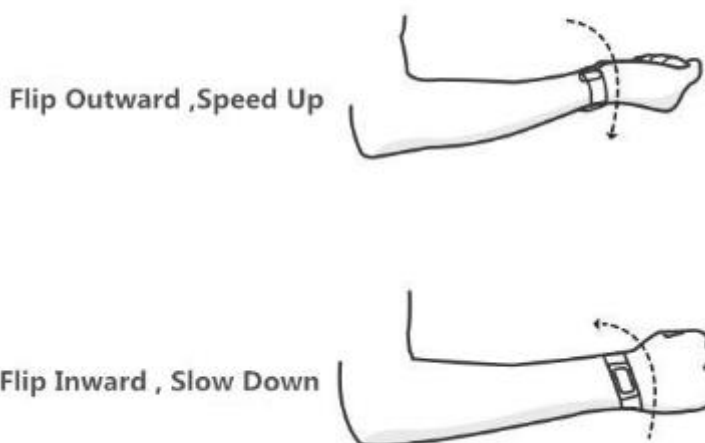

	PL	EN	RU	CZ	SK	LT	LV	DE
1	Odwróć na zewnątrz, aby przyspieszyć	Flip Outward, Speed up	Повернуть по часовой стрелке – ускорить	Otoč na větší stranu, Zrychli	Otoč na vejšia stranu, Zrychli	Pasukite į išorę, Paspartinkite	Apgrīziet uz ārpusi, Paātrināt	Nach draußen drehen, beschleunigen
2	Odwróć do wewnątrz, aby zwolnić	Flip inward, Slow down	Повернуть против часовой стрелки – замедлить.	Otoč na vnitřní stranu, Zpomal	Otoč na vnútornú stranu, Spomaľ	Pasukite į vidų, Sulėtinkite	Apgrīziet uz iekšpusi, Palēnināt	Nach innen drehen, verlangsamen

**Specyfikacja urządzenia | Basic specification | Базовая спецификация |
Základní specifikace | Základná špecifikácia | Pagrindinė specifikacija | Pamata specifikācijas | Spezifikation**

	PL	EN	RU	CZ	SK	LT	LV	DE	
1	Czujnik	Sensor	Датчик	Snímač	Snímač	Jutiklis	Sensors	Sensor	KXTJ2-1009/PD7 0-01C-TR7
2	Waga urządzenia	Host weight	Вес изделия	Hmotnost	Hmotnosť	Įrangos svoris	Resursda-tora svars	Host-Gewicht	22g
3	Synchronizacja danych	Data Sync.	Синхронизация данных	Synchronizace dat	Synchronizácia dát	Duomenų sinchronizavimas	Datu sinhronizācija	Datensynchronisation	Bluetooth 4.0
4	Typ baterii: Akumulator Li	Battery Type rechargeable	Тип батареи: литиевая батарея	Typ baterie: Baterie Li	Typ batérie: Batéria Li	Akumulatoriaus tipas: Li	Baterijas veids: Li	Batterietyp: Li-Batterie	Li
5	Pojemność baterii	Battery Capacity	Емкость батареи	Kapacita baterie	Kapacita batérie	Akumulatoriaus talpa	Bateriju tilpums	Batteriekapazität	90mAh
6	Tryb gotowości	Standby	Режим ожидания	Pohotovostní režim	Pohotovostný režim	Pasiruošimo režimas	Gatavības režīms	Standby-Modus	4
7	Rozmiar ekranu	Screen Size	Размер экрана	Rozměr displeje	Rozmer displeja	Ekrano dydis	Ekrāna izmērs	Bildschirmgröße	0.91
8	Napięcie wejściowe	Input Voltage	Входное напряжение	Vstupní napětí	Vstupné napätie	Įėjimo įtampa	Ieejas spriegums	Eingangsspannung	5V
9	Temp. robocza	Working Temperature	Рабочая Температура	Pracovní teplota	Pracovná teplota	Darbinė temp.	Darba temp.	Arbeitstemperatur	0C-40C
10	Wodoszczelność	Waterproof level	Водонепроницаемость	Vodotěsnost	Vodotesnosť	Nelaidumas vandeniui	Ūdensnecaurlaidība	Wasserdich-tigkeit:	IPX7

UWAGI Proszę zatrzymać niniejszą instrukcję do późniejszego wykorzystania.

SMARTBAND

ŁADOWANIE


Przymocuj port ładowania do punktu ładowania opaski. Drugą końcówkę przewodu ładującego podłącz do wtyczki USB lub do portu USB komputera.

Opaska pokaże ikonę ładowania. Pełen czas ładowania wynosi około 2 godziny.

- 1) Port ładowania USB
- 2) Ładowanie
- 3) Ładowanie zakończone

PRĘDKOŚĆ DOSTOSOWANA DO TĘTNA

Po połączeniu z aplikacją Gfit wybierz interfejs pomiaru tętna, a prędkość będzie automatycznie dostosowana do wartości tętna.

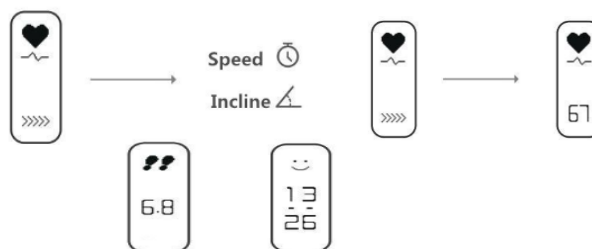

POMIAR KROKÓW / MODUŁ CZASOWY

Dotknij przycisku dotykowego, aby wyświetlić liczbę kroków.

Kiedy ekran jest wyłączony, unieś nadgarstek by go włączyć – ekran wskaże czas.

FAQ

Upewnij się, że Bluetooth w telefonie jest włączony i że telefon jest wyposażony w system Android 4.4 lub wyższy lub iOS 8.0 lub wyższy, oraz moduł Bluetooth 4.0 (BLE).

1. Jak czyścić opaskę?

- a. Wytrzyj mokrym ręcznikiem lub miękką szmatką (nie używaj agresywnych środków czyszczących).
- b. Punkty kontaktowe ładowania wycieraj do sucha po kontakcie z wodą.

2. Czy można nosić opaskę podczas mycia rąk / biorąc prysznic, podczas pływania?

- a. Opaska jest odporna na zachlapania, można ją nosić podczas mycia rąk.
- b. Opaska nie jest przeznaczona do pływania, używania w saunie, łaźni parowej ani kąpeli.

UWAGA

Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj opaski, nie ściskaj, ani nie wkładaj akumulatora w miejsca o zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temp. Może to spowodować wybuch lub pożar.

Jeśli czujesz podrażnienie skóry, swędzenie i podobne działania niepożądane podczas noszenia opaski, należy natychmiast ją zdjąć i skonsultować się z lekarzem.

Nie wolno nakładać farby lub naklejać papieru na urządzenie, spowoduje to, że części urządzenia się zablokują i normalne użytkowanie będzie niemożliwe.

Napraw może dokonywać tylko wykwalifikowany personel, w innym przypadku może dojść do uszkodzenia sprzętu. Gwarancja producenta nie obejmuje napraw wykonywanych przez niewykwalifikowany personel.

OSTRZEŻENIE

Należy używać wyłącznie zatwierdzonych przez producenta: baterii, ładowarek, akcesoriów i produktów pokrewnych.

Urządzenia nie można narażać na uderzenia, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.

Nie należy zostawiać opaski w przegrzanych lub zbyt zimnych miejscach. Zalecana temperatura użytkowania to 0°C-40°C.

Opaska nie może znajdować się wewnątrz lub w pobliżu grzejników, kucharek mikrofalowych, urządzeń do gotowania lub zbiorników wysokociśnieniowych.

Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom na żucie lub polykanie urządzenia.

Aby zminimalizować zakłócenia rozrusznika serca, urządzenie należy nosić na nadgarstku po przeciwnej stronie rozrusznika.

Nie kieruj zapalonych diod w stronę oczu człowieka ani zwierzęcia.

Urządzeniem nie wolno uderzać w oczy, uszy lub inne części ciała, ani umieszczać go w ustach.

W przypadku korzystania ze sprzętu medycznego należy skontaktować się z jego producentem w celu ustalenia, czy częstotliwość radiowa emitowana przez opaskę smartband będzie wpływać na urządzenie medyczne.

Częstotliwości radiowe emitowane przez opaskę mogą zakłócać działanie niektórych aparatów słuchowych. Skontaktuj się z producentem Twojego aparatu słuchowego przed rozpoczęciem korzystania z opaski smartband.

TOKSYCZNE I NIEBEZPIECZNE SUBSTANCJE LUB PIERWIASTKI

Nazwa części	Toksyczne i niebezpieczne substancje lub pierwiastki					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE
Plastikowa obudowa	0	0	0	0	0	0
Płytki	X	0	0	0	0	0
Bateria	X	0	0	0	0	0
Inne części	0	0	0	0	0	0

0: Wskazuje, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych w jednorodnym materiale części jest niższa od wymogu granicznego Si/T11363-2006 "wymagania ograniczenia dotyczące toksycznych i niebezpiecznych materiałów w urządzeniach elektronicznych".

% Wskazuje, że zawartość substancji toksycznych i niebezpiecznych w co najmniej jednym jednorodnym materiale części przekracza wymóg graniczny 52/T11363-2006.

Uwagi:

1. Urządzenia jednopłytkowe/-obwodowe zawierają ołów w stopach miedzi lub lucie wysokotemperaturowym.
2. Obwód akumulatora z Pb.



CE RoHS

Dotyczy licznika

Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Zgodnie z Dyrektywą WEE o sposobie gospodarowania zużytymi odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, dla tego typu sprzętu należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. Użytkownik, który zamierza pozbyć się tego produktu, zobowiązany jest do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dzięki czemu przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu, bądź odzysku, a tym samym do ochrony środowiska naturalnego. W tym celu należy skontaktować się z punktem w którym urządzenie zostało nabyte, lub z przedstawicielami władz lokalnych. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie ludzi.

NOTES Please keep this operation manual for future use.

SMARTBAND


HOW TO CHARGE

Attach the charging port to the band's charging contact point. Connect the other end of the charging cable to the USB power plug or the computer's USB port.

The smartband will show the charging icon, which indicates charging. Full charging time is about 2 hours.

SPEED ADJUSTED TO HEART RATE

Connect to Gfit and enter the heart rate measurement interface. The speed will be automatically adjusted according to the heart rate.

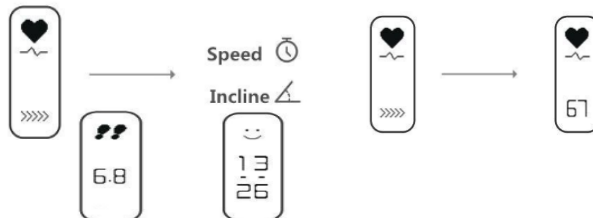

STEP MEASUREMENT / TIME MODE

Click the touch key to view the number of steps. When the screen is off, lift the wrist to turn the screen on and show the time.

FAQ

Make sure that the Bluetooth in your smartphone is ON and the operation system is Android 4.4 & higher or iOS 8.0 & higher and Bluetooth 4.0 (BLE).

1. How to clean the smartband?

- a. Wipe the band with a wet towel or a soft cloth (do not use corrosive solvents).
- b. Charging contact point should be wiped dry after contact with water. Please ensure that the charging contact point is dry.

2. Can you wear the band when washing hands / taking shower or swimming?

- a. The band reaches the IPX7 waterproof level, you can wear the band when washing hands.
- b. The smartband is not suitable for swimming or soaking in water, sauna or steam bath.

PRECAUTION

Do not disassemble, modify or repair the smartband, do not squeeze the battery or expose it to heat or freezing temperatures. This may cause an explosion or fire. If you experience skin irritation, itching or related adverse reactions after wearing the band, remove it immediately and consult a medical professional. Do not cover the band with paint or adhesive tape /

paper, which may cause some parts to block and affect normal operation. Only qualified personnel is entitled to conduct repairs. Any repairs conducted by unauthorized persons may damage the smartband and void the warranty.

WARNING

Use only batteries, chargers and accessories approved by the manufacturer.

Do not expose the smartband to physical impact, which may damage the device.

Do not expose the smartband to heat or freezing temperatures.

Recommended operation temperature is 0°C - 40°C.

Do not put the band inside or near heaters, microwave ovens, cooking appliances or high pressure vessels.

Do not allow children or animals to chew or swallow the device.

To minimize interference with cardiac pacemakers, use the device on the handwrist opposite to the pacemaker.

If the diodes are flashing, do not use the smartband near the eyes of a human or animal.

Do not hit the eyes, ears or other parts of the body with the device, or put the device into your mouth.

If you use medical equipment, contact the medical equipment manufacturer before using the smartband to determine if the medical equipment will be affected by the radio frequency emitted by the band.

The radio frequencies emitted by this equipment may interfere with certain hearing instruments. Contact the manufacturer before using the smartband to determine if it will be affected by the radio frequency emitted by this equipment.

Parts Name	Toxic and Hazardous Substances or Elements					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Plastic Case	0	0	0	0	0	0
Circuit						
Module	x	0	0	0	0	0
Batter),	X	0	0	0	0	0
Other Parts	0	0	0	0	0	0

0: Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in the homogeneous material of the part is below the limit requirement of Si / T11363-2006 "Limitation requirements of toxic and hazardous materials in electronic information products".

X Indicates that the content of the toxic and hazardous substance in at least one homogeneous material of the part exceeds the limit requirement of 52 / T11363-2006.

Directions:

- 1. Single-board / circuit module devices contain lead in copper alloys or high temperature solder.
- 2. Battery circuit with Pb.



CE RoHS

Refers to the meter

The equipment label depicting a crossed-out wheeled bin symbol informs that it is forbidden to dispose of waste electrical and electronic equipment together with other types of waste. In accordance with the WEE directive on waste electrical and electronic equipment, separate waste management processes should be applied for this type of equipment. The user who intends to dispose of such a product is obliged to return it to an electronic equipment collection point thanks to which they can contribute to its re-use, recycling, and recovery and, in this way, protect the environment. To do this, contact the sales point where the equipment was purchased or a representative of the local authorities. Hazardous substances included in electronic equipment can have negative long-term influence on the natural environment and they can also have negative effect on human health.

SMARTBAND

ЗАРЯДКА


Присоедините порт зарядки к точке зарядки браслета. Подключите другой конец зарядного кабеля к разъему USB или к порту USB вашего компьютера.

На браслете появится значок зарядки. Время полной зарядки составляет около 2 часов.

- 1) USB-порт для зарядки
- 2) Зарядка
- 3) Зарядка завершена

СКОРОСТЬ, ДЛЯ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

После подключения к приложению Gfit выберите интерфейс пульса, и скорость будет автоматически настроена на ваш пульс.

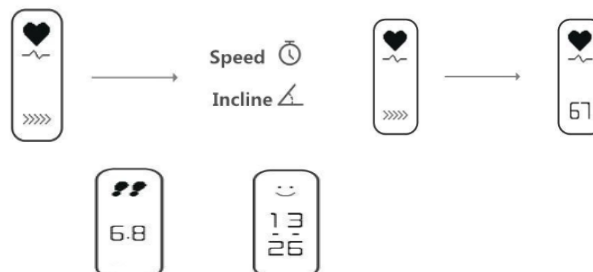

ИЗМЕРЕНИЕ ШАГОВ / МОДУЛЬ ВРЕМЕНИ

Нажмите сенсорную кнопку, чтобы отобразить количество шагов.

Когда экран выключен, поднимите запястье, чтобы включить его - на экране будет показано время

FAQ

Убедитесь, что Bluetooth на вашем телефоне включен, и ваш телефон оснащен Android 4.4 или выше или iOS 8.0 или выше, и Bluetooth 4.0 (BLE).

1. Как чистить браслет и зарядные устройства?

a. Протрите влажной тканью или мягкой тканью (не используйте агрессивные чистящие средства).

b. Зарядные контактные точки, вытрите насухо после контакта с водой

2. Можно ли носить браслет при мытье рук / принятии душа во время плавания?

a. Браслет устойчив к брызгам, его можно носить при мытье рук.

b. Браслет не предназначен для плавания, для использования в сауне, паровой бане или бане.

ПРИМЕЧАНИЕ

Не разбирайте, не модифицируйте и не ремонтируйте браслет, не сдавливайте и не помещайте батарею в местах, где температура слишком высокая или слишком низкая.

Это может привести к взрыву или пожару.

Если вы чувствуете раздражение кожи, зуд и подобные побочные эффекты при ношении браслета, немедленно снимите его и обратитесь к врачу.

Не разрешается наносить краску или наклеивать на устройство бумагу, это может привести к блокировке частей устройства и невозможности нормального использования.

Ремонт может выполняться только квалифицированным персоналом, в противном случае оборудование может быть повреждено. Гарантия производителя не распространяется на ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом..

ВНИМАНИЕ!

Используйте только одобренные производителем: аккумуляторы, зарядные устройства, аксессуары и сопутствующие товары.

Устройство не может подвергаться ударам, так как можно повредить его.

Не оставляйте ленту в перегретых или слишком холодных местах. Рекомендуемая температура использования составляет от 0 ° C до 40 ° C. Лента не должна быть внутри или рядом с нагревателями, микроволновыми печами, кухонными приборами или резервуарами высокого давления.

Не позволяйте детям или животным жевать или глотать устройство.

Чтобы свести к минимуму помехи от кардиостимулятора, устройство следует носить на запястье на противоположной стороне кардиостимулятора.

Не направляйте освещенные диоды в направлении глаз человека или животного. Устройство не может попадать в глаза, уши или другие части тела или помещено в рот.

Если вы используете медицинское оборудование, пожалуйста, свяжитесь с производителем, чтобы определить, повлияет ли радиочастота, излучаемая смарт-браслетом, на медицинское устройство.

Радиочастоты, излучаемые браслетом, могут мешать работе некоторых слуховых аппаратов. Обратитесь к производителю слухового аппарата перед использованием смартфона

Название элемента	Токсичные и опасные вещества или элементы					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE
Пластиковый корпус	0	0	0	0	0	0
Схема Модуль	X	0	0	0	0	0
Аккумулятор	X	0	0	0	0	0
Другие элементы	0	0	0	0	0	0

я0: указывает на то, что содержание токсичных и опасных веществ в однородном материале деталей ниже, чем предельное требование Si / T11363-2006 «Требования к ограничениям на токсичные и опасные материалы в электронных информационных продуктах».

X: Указывает, что содержание токсичных и опасных веществ по меньшей мере в одном однородном материале детали превышает предельное требование 52 / T11363-2006.

Замечания:

1. Устройства и схемы содержат свинец в медных сплавах или высокотемпературных материалах.
2. Схема аккумулятора также содержит свинец.



Касается счетчика

Обозначение тренажера символом перечеркнутого контейнера для мусора сообщает о запрете размещения использованного электрооборудования и электротехники вместе с другим бытовым мусором. Согласно Директиве WEEE о способе распоряжения использованного электрооборудования и электротехники, для данных предметов следует применять отдельные способы утилизации. Потребитель, который намерен избавиться от изделия, обязан отдать его в пункт сбора использованного электрооборудования и электротехники, и таким образом, обеспечивает повторное употребление, рециклинг, тем самым, защищает окружающую среду. Для этого следует связаться с пунктом, в котором данное оборудование было куплено или с представителями местных властей. Опасные элементы, сосредоточенные в электрооборудовании могут привести к продолжительным и неблагоприятным изменениям натуральной среды, а также, отрицательным образом воздействовать на здоровье людей.

POZNÁMKY Ponechte si prosím tento návod k pozdějšímu použití.

SMARTBAND


JAK PŘÍSTROJ NABÍJET

Nabíjecí kabel připojte k nabíjecímu bodu nabíjení na hodinkách. Druhý konec nabíjecího kabelu připojte ke konektoru USB nebo k portu USB počítače.

Jakmile se začne náramek nabíjet, objeví se ikona nabíjení. Nabíjení do plna trvá cca 2 hodiny.

BĚŽECKÝ PÁS, KTERÝ KONTROLUJE VAŠI TEPOVOU FREKVENCÍ / MĚŘENÍ SRDEČNÍ FREKVENCE

Jestliže jste připojeni k aplikaci Gfit, bude rychlost automaticky nastavena podle vaší tepové frekvence. Zadejte rozhraní tepové frekvence, nehybejte pažemi, náramek začne ukazovat vaši tepovou frekvenci později.

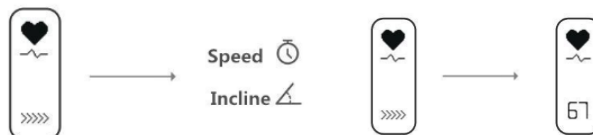

MĚŘENÍ KROKŮ / ZOBRAZENÍ ČASU

Kliknutím na dotykové tlačítko zobrazíte počet kroků. Když je displej vypnutý, zvednete zápěstí a na displeji se vám zobrazí čas.



NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

1. Nemůžete se připojit k aplikaci?

Zkontrolujte, zda máte zapnuté Bluetooth v telefonu a zda je telefon vybaven Android 4.4 a vyšším, iOS 8.0 a vyšším a Bluetooth 4.0 (BLE).

2. Jak čistit řemínek? Jak vyčistit kontaktní bod nabíjení?

a. Řemínek lze otřít vlhkým ručníkem nebo měkkým hadříkem (nepoužívejte agresivní rozpouštědla).

b. Kontaktní bod pro nabíjení setřete do sucha měkkým hadříkem a ujistěte se, že je kontaktní místo pro nabíjení suché.

3. Vodotěsnost. Mohu nosit náramek při mytí rukou / při sprchování?

a. Náramek je vodotěsný, lze jej nosit při mytí rukou.

b. Náramek nemůže být dlouho ve vodě, v sauně, parní lázni nebo v koupeli.

OPATŘENÍ

Náramek nijak nerozebírejte, sami neopravujte, nemačkejte jej, a ani nevkládejte baterii, když je okolní teplota příliš vysoká nebo naopak nízká, což může způsobit výbuch či požár.

Jestliže při nošení náramku pociťujete podráždění kůže, svědění či podobné nežádoucí účinky, okamžitě jej sundejte a vyhledejte lékaře.

Náramek v žádném případě nepolepujte samolepkou a nepoužívejte žádné barvy. Způsobí to, že se součástky náramku zablokují a běžné používání již nebude možné.

Opravy smí provádět pouze kvalifikovaná osoba, jinak může dojít k poškození náramku. Záruka se nevztahuje na opravy prováděné nekvalifikovanými osobami.

VAROVÁNÍ

Používejte baterie, nabíječky, příslušenství a související produkty schválené pouze výrobcem

Zařízení nesmí být vystaveno nárazům, mohlo by dojít k jeho poškození.

Nevystavujte zařízení na přehřátém nebo příliš chladném místě.

Doporučená teplota prostředí je 0°C - 40°C

Náramek nesmí být ve středu nebo v blízkosti topných těles:

mikrovlnná trouba, kuchyňské spotřebiče nebo vysokotlaké nádoby

Nedovolte dětem ani zvířatům, aby zařízení žvýkali nebo polknuli.

Abyste minimalizovali rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na opačné straně kardiostimulátoru.

Pokud je přístroj vybaven bleskem nebo lampou, nepoužívejte jej v blízkosti lidských nebo zvířecích očí.

Přístrojem nesmí být zasaženy oči, uši nebo jiné části těla a nevkládejte jej ani do úst.

Pokud používáte zdravotnická zařízení, obraťte se před použitím přístroje na výrobce zdravotnického zařízení, abyste zjistili, zda rádiová frekvence vysílaná přístrojem nijak neovlivní lékařský přístroj.

Rádiové frekvence vysílané tímto přístrojem mohou rušit některé naslouchátka. Před použitím tohoto zařízení, se obraťte na výrobce pro zjištění, zda to bude mít vliv na rádiovou frekvenci vyzařovaného tímto přístrojem.

Název prvku	Toxické a nebezpečné látky nebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Plastový kryt	0	0	0	0	0	0
Obvod Modul	X	0	0	0	0	0
Baterie	X	0	0	0	0	0
Jiné části	0	0	0	0	0	0

0: Udává, že obsah toxických a nebezpečných látek v homogenní části materiálu je nižší než mezní požadavek Si/T11363-2006 "požadavky na omezení toxických a nebezpečných materiálů v elektronických informačních produktech".

X Udává, že obsah toxických a nebezpečných látek v alespoň jedné části homogenního materiálu převyšuje mezní požadavek 52/T11363-2006.

Směry:

1. Zařízení jednodlažní / obvodové obsahují olovo ve slitinách mědi nebo ve vysokých teplotách.

2. Obvod baterie s Pb



CE RoHS

Týká se počítačů

Označení zařízení symbolem škrtnutého kontajneru na odpad informuje o zákazu umístování odpadních elektrických a elektronických zařízení spolu s jiným odpadem. Podle směrnice ES o způsobu nakládání s elektrickým a elektronickým odpadem, by měl tento druh zařízení být podroben zvláštní utilitaci. Uživatel, který má v úmyslu zbavit se tohoto produktu, je povinen vrátit ho do místa sběru odpadních elektrických a elektronických zařízení, a přispět tak k opětovnému použití, recyklaci nebo využití, a chránit tak životní prostředí. Za tímto účelem obraťte se na místo, kde jste výrobek zakoupili, nebo kontaktujte zástupce místních úřadů. Nebezpečné složky v elektronických zařízeních mohou vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky v životním prostředí, stejně jako mohou poškozovat lidské zdraví.

POZOR Tento návod na obsluhu dobre uschovajte pre prípad jeho použitia v budúcnosti.

SMARTBAND


AKO PRÍSTROJ NABÍJAŤ

Nabíjací kábel pripojte k nabíjacíemu bodu nabíjania na hodinkách. Druhý koniec nabíjacieho kábla pripojte k konektoru USB alebo k portu USB počítača. Akonáhle sa začne náramok nabíjať, objaví sa ikona nabíjania. Nabíjanie do plna trvá cca 2 hodiny.

- 1) Nabíjací USB kábel
- 2) Nabíjanie
- 3) Nabíjanie dokončené

BEŽECKÝ PÁS, KTORÝ KONTROLUJE VAŠU TEPOVÚ FREKVENCIU / MERANIE SRDCOVEJ FREKVENCIE

Ak ste pripojení k aplikácii Gfit, bude rýchlosť automaticky nastavená podľa vašej tepovej frekvencie. Zadajte rozhrania tepovej frekvencie, nehybte pažami, náramok začne ukazovať vašej tepovej frekvencie neskôr.

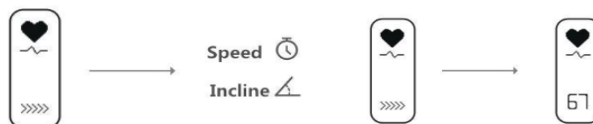

MERANIE KROKOV / ZOBRAZENIE ČASU

Kliknutím na dotykové tlačidlo zobrazíte počet krokov. Keď je displej vypnutý, zdvihnite zápästia a na displeji sa vám zobrazí čas.



FAQ

1. Nemôžete sa pripojiť k aplikácii?
Skontrolujte, či máte zapnuté Bluetooth v telefóne a či je telefón vybavený Android 4.4 a vyšším, iOS 8.0 a vyšším a Bluetooth 4.0 (BLE).
2. Ako čistiť remienok? Ako vyčistiť kontaktný bod nabíjania?
a. Remienok možno utrieť vlhkým uterákom alebo mäkkou handričkou (nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá).

- b. Kontaktný bod pre nabíjanie zotrite do sucha mäkkou handričkou a uistite sa, že je kontaktný bod pre nabíjanie suchý.
3. Vodotesnosť. Môžem nosiť náramok pri umývaní rúk / pri sprchovaní?
a. Náramok je vodotesný, možno ho nosiť pri umývaní rúk.
b. Náramok nemôže byť dlho vo vode, v saune, parnej kúpeľi alebo v kúpeľi.

OPATRENIA

Náramok nijako nerozoberajte, sami neopravujte, nestláčajte ho, a ani nekladajte batériu, keď je okolitá teplota príliš vysoká alebo naopak nízka, čo môže spôsobiť výbuch alebo požiar.

Ak pri nosení náramku pociťujete podráždenie kože, svrbenie či podobné nežiaduce účinky, okamžite ho dajte dolu a vyhľadajte lekára.

Náramok v žiadnom prípade neolepujte samolepkou a nepoužívajte žiadne farby. Spôsobí to, že sa súčiastky náramku zablokujú a bežné používanie už nebude možné.

Opravy môže vykonávať iba kvalifikovaná osoba, inak môže dôjsť k poškodeniu náramku. Záruka sa nevzťahuje na opravy vykonávané nekvalifikovanými osobami.

VAROVANIE

Používajte batérie, nabíjačky, príslušenstvo a súvisiace produkty schválené iba výrobcom

Zariadenie nesmie byť vystavené nárazom, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

Nevystavujte zariadenie na prehriatom alebo príliš chladnom mieste. Odporúčaná teplota prostredia je 0 °C - 40 °C

Náramok nesmie byť v strede alebo v blízkosti vykurovacích telies:

- mikrovlnná rúra, kuchynské spotrebiče alebo vysokotlakové nádoby
- Nedovoľte deťom ani zvieratám, aby zariadenie žuvali alebo prehltoli. Aby ste minimalizovali rušenie kardostimulátora, používajte prístroj na opačnej strane kardostimulátora.

Ak je prístroj vybavený bleskom alebo lampou, nepoužívajte ho v blízkosti ľudských alebo zvieracích očí.

Prístrojom nesmie byť zasiahnuté oči, uši alebo iné časti tela a nekladajte ho ani do úst.

Ak používate zdravotnícke zariadenia, obráťte sa pred použitím prístroja na výrobcu zdravotníckeho zariadenia, aby ste zistili, či rádiová frekvencia vysielaaná prístrojom nijako neovplyvní lekárske prístroje.

Rádiové frekvencie vysielaané týmto prístrojom môžu rušiť niektoré naslúchadla. Pred použitím tohto zariadenia, kontaktujte výrobcu pre zistenie, či to bude mať vplyv na rádiovú frekvenciu vyžarovaného týmto prístrojom..

Názov prvku	Toxické a nebezpečné látky alebo prvky					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE
Plastový kryt	0	0	0	0	0	0
Obvod Modul	X	0	0	0	0	0
Batérie	X	0	0	0	0	0
Iné časti	0	0	0	0	0	0

0: Udáva, že obsah toxických a nebezpečných látok v homogénnej časti materiálu je nižšia ako medzná požiadavka Si / T11363-2006 "požiadavky na obmedzenie toxických a nebezpečných materiálov v elektronických informačných produktoch".

% Udáva, že obsah toxických a nebezpečných látok v aspoň jednej časti homogénneho materiálu presahuje jednodňovú požiadavku 52 / T11363-2006.

Smery:

1. Zariadenie jednodňazné / obvodové obsahujú olovo v zliatinách medi alebo vo vysokých teplotách.
2. Obvod batérie s Pb



CE RoHS

Vzťahuje sa na počítač

Označenie zariadenia symbolom s prečiarknutým kontajnerom na odpad informuje o tom, že sa opotrebené elektrické a elektronické zariadenie nesmie vyhodiť s komunálnym odpadom. V súlade so Smernicou OEEZ o odpade z elektrických a elektronických zariadení tento druh odpadu je potrebné odstraňovať iným spôsobom. Používateľ, ktorý sa chce zbaviť tento produkt, je povinný odovzdať ho na mieste zberky opotrebených elektrických a elektronických zariadení, vďaka čomu produkt sa môže opätovne využiť, recyklovať alebo obnoviť a tým prispieť k ochrane životného prostredia. Aby to urobil, kontaktujte podnik, v ktorom ste kúpili zariadenie alebo zástupcov miestnej vlády. Nebezpečné látky, ktoré obsahujú elektronické zariadenia, môžu byť zapríčiniť nepožadované zmeny v životnom prostredí a aj škodiť ľudskému zdraviu.

PASTABOS Palaikykite šią instrukciją vėlesniam naudojimui.

SMARTBAND


ĮKROVIMAS

Prijunkite įkrovimo prievadą prie apyrankės įkrovimo taško. Kitą įkrovimo laido galą prijunkite prie USB kištuko arba prie kompiuterio USB prievado. Apyrankė rodys įkrovimo piktogramą. Pilnas laikas tai apie 2 valandos.

- 1) USB įkrovimo lizdas
- 2) Įkrovimas
- 3) Įkrovimas užbaigtas

GREITIS PRITAIKYTAS PRIE PULSO

Prisijungę prie „Gfit“ programos, pasirinkite širdies ritmo matavimo sąsają ir greitis bus automatiškai pritaikytas prie širdies ritmo

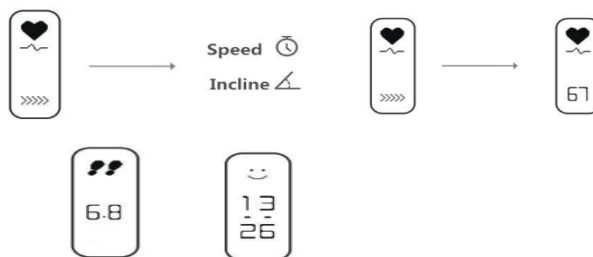

ŽINGSNIŲ MATAVIMAS / LAIKO MODULIS

Spustelėkite jutiklinį mygtuką, kad būtų rodomas žingsnių skaičius. Kai ekranas išjungtas, pakelkite riešą, kad jį įjungtumėte - ekrane bus rodomas laikas

FAQ

Įsitikinkite, kad jūsų telefono „Bluetooth“ įjungtas ir ar telefone yra Android 4.4 ir naujesnės versijos, ir iOS 8.0 ir naujesnės versijos bei „Bluetooth 4.0“ (BLE).

1. Kaip valyti apyrankę?

a. gali būti nuvaloma drėgnu rankšluosčiu arba minkštu audiniu (nenaudokite stiprių tirpiklių).

b. įkrovimo kontaktinis taškas gali būti nuvalytas, įsitikinkite, kad įkrovimo kontaktinis taškas yra sausas.

2. Ar galiu dėvėti apyrankę, kai plaunate rankas, plaukiojate.

a. apyrankė yra nepralaidi vandeniui, ją galima dėvėti rankų plovimo metu.

b. apyrankė ilgą laiką negali būti vandenyje, pirtyje, garų pirtyje, vonioje.

PASTABA

Negalima išardyti, keisti ar taisyti apyrankės, nespauskite arba nedėkite akumulatoriaus vietose, kur temperatūra yra per didelė arba per maža.

Tai gali sukelti sprogamą ar gaisrą.

Jei dėvėdami šią apyrankę jaučiate odos dirginimą, niežulį ir panašius šalutinius poveikius nedelsdami nuimkite ją ir pasitarkite su gydytoju.

Ant prietaiso nenaudokite dažų ir neklijuokite lipdukų, nes dėl to prietaiso dalys gali susiblokuoti ir įprastas naudojimas nebus įmanomas.

Remontą gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, kitaip įranga gali būti pažeista. Gamintojo garantija neapima kvalifikuoto personalo atlikto remonto..

ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik gamintojo patvirtintas baterijas, įkroviklius, priedus ir susijusius gaminius.

Prietaisas negali būti paveiktas dūžiais, nes tai gali sukelti jo defektus.

Nepalikite apyrankės per šiltose ar per šaltose vietose. Rekomenduojama temperatūra tai 0°C-40°C.

Apyrankė negali būti šildytuvų, mikrobangų krosnelių, virimo prietaisų ar aukšto slėgio rezervuarų viduje ar šalia jų.

Neleiskite vaikams ar gyvūnams kramtyti ar nuryti prietaiso.

Kad būtų sumažintas poveikis širdies stimulatoriui, prietaisas turi būti dėvimas ant riešo, priešingoje širdies stimulatoriaus pusėje.

Nenukreipkite šviečiančių diodų žmonių ar gyvūnų akių kryptimi. Prietaisu negali daužyti akių, ausų ar kitų kūno dalių ar dėti jo į burną.

Jei naudojate medicininę įrangą, prieš naudodami prietaisą kreipkitės į medicinos įrangos gamintoją, kad nustatytumėte, ar išmaniosios apyrankės skleidžiamas radijo dažnis paveiks medicinos prietaisą.

Apyrankės skleidžiami radijo dažniai gali trikdyti kai kuriuos klausos aparatus. Prieš naudodami išmaniają apyrankę kreipkitės į savo klausos aparato gamintoją..

Dalių pavadinimas	Toksiškos ir pavojingos medžiagos arba mikroelementai					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁶⁺	PBB	PBDE
Plastiko korpusas	0	0	0	0	0	0
Perimetras	X	0	0	0	0	0
Modulis	X	0	0	0	0	0
Baterija),	X	0	0	0	0	0
Kitos dalys	0	0	0	0	0	0

0: Nurodo, kad toksiškų ir pavojingų medžiagų kiekis homogeninėje medžiagų dalyje yra mažesnis nei Si / T11363-2006 „Reikalavimai dėl apribojimų, taikomų toksiškoms ir pavojingoms medžiagoms elektroniniuose informacijos produktuose“.

X Nurodo, kad toksiškų ir pavojingų medžiagų kiekis bent vienoje homogeninėje medžiagos dalyje viršija ribinį reikalavimą 52 / T11363-2006.

Kryptys:

1. Vieno denio / periferiniuose įrenginiuose yra švino vario lydiniuose arba aukštos temperatūros laiduose.

2. Akumulatoriaus su Pb grandinė



CE RoHS

Taikoma skaitikliui

Perbrauktos šiukšliadėžės simbolis nurodomas ant produkto reiškia, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekas draudžiama išmesti kartu su kitomis atliekomis. Sutinkamai su EEI direktyva dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo, šiai įrangai taikomi atskiri šalinimo metodai. Vartotojas, kuris ketina pašalinti šį produktą, įpareigotas jį atiduoti į elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo aikštelę, paskatindamas pakartotinį naudojimą, perdirbimą, ir natūralios aplinkos apsaugą. Šiuo tikslu, susisiekite su produkto pardavėju, arba vietinių valdžių atstovu. Pavojingos elektroninės įrangos sudedamosios dalys gali sukelti nepalankius ilgalaikius aplinkos pakitimus, ir kenkti žmonių sveikatai.

SMARTBAND

LĀDĒŠANA

Nostipriniet lādēšanas portu pie aprocas lādēšanas punkta. Otru lādēšanas kabeļa galu pieslēdziet USB spraudnim vai datora USB portam.

Aproce parāda lādēšanas ikonu. Pilns lādēšanas cikls ilgs aptuveni 2 stundas..


1) USB lādēšanas ports

2) Lādēšana

3) Lādēšana pabeigta

ĀTRUMA PIELĀGOŠANA PULSAM

Pēc savienošanas ar aplikāciju *Gfit* izvēlieties pulsa mērīšanas interfeisu. Ātrums tiek automātiski pielāgots pulsam..

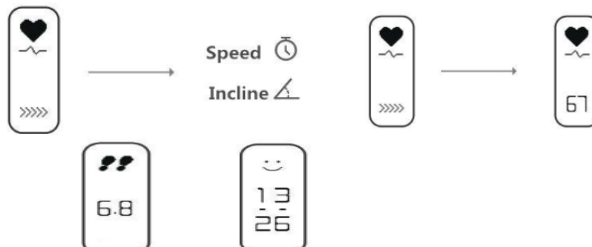

SOĻU MĒRĪŠANA / LAIKA MODULIS

Pieskarieties skārienjutīgajai pogai, lai parādītu soļu skaitu.

Ja ekrāns ir izslēgts, paceliet roku, lai to ieslēgtu, — ekrānā parādās laiks..

FAQ

Pārliecinieties, ka *Bluetooth* tālrunī ir ieslēgts un ka tālrunis ir aprīkots ar sistēmu *Android 4.4* vai augstāku vai *iOS 8.0* vai augstāku un ar moduli *Bluetooth 4.0 (BLE)*.

1. Kā tīrīt viedaprocī un lādēšanas punktus?

a. Noslaukiet viedaprocī ar slapju dvieli vai mīkstu lupatiņu (neizmantojiet agresīvus tīrīšanas līdzekļus).

b. Pilnībā nosusiniet lādēšanas punktus pēc to saskares ar ūdeni..

2. Vai viedaprocī var valkāt, mazgājot rokas, ejot dušā vai peldoties?

a. Viedproce ir izturīga pret ūdens šļakatām, to var valkāt, mazgājot rokas.

b. Viedproce nav paredzēta peldēšanai, lietošanai saunā, tvaika pirtī, vannā.

PIEZĪMES

Nedemontējiet, nemodificējiet un neremontējiet viedaprocī. Nesaspiediet akumulatoru un novietojiet to vietās ar pārāk augstu vai pārāk zemu temperatūru. Tas var novest pie sprādziena vai ugunsgrēka.

Ja viedaprocē lietošanas laikā jūtat ādas kairinājumu, niezi un līdzīgas blakusparādības, nekavējoties noņemiet to un sazinieties ar ārstu. Uz ierīci

nedrīkst uzlikt krāsu vai uzlīmēt papīru, tas noved pie ierīces elementu bloķēšanas un padara par neiespējamu tās normālu lietošanu.

Remontus var veikt tikai kvalificēts personāls, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta. Ražotāja garantija neattiecas uz nekvalificēta personāla veiktiem remontiem

BRĪDINĀJUMS

Izmantojiet tikai ražotāja apstiprinātas baterijas, lādētājus, piederumus un līdzīgus izstrādājumus.

Ierīci nedrīkst pakļaut triecieniem, jo tas var novest pie tās bojājuma.

Neatstājiet aproci pārkarsušās un pārāk aukstās vietās. Ieteicamā temperatūra ir 0–40 °C.

Aproce nedrīkst atrasties radiatoru, mikroviļņu krāšņu, vārišanas ierīču vai augstspiediena tvertņu iekšā vai tuvumā.

Neļaujiet bērniem un dzīvniekiem košļāt vai norīt ierīci. Lai samazinātu sirds stimulatora darbības traucējumus, valkājiet ierīci uz rokas stimulatoram pretējā pusē.

Nevērsiet degošas gaismas diodes pret cilvēka vai dzīvnieka acīm.

Ar ierīci nedrīkst sist pa acīm, ausīm vai citām ķermeņa daļām un ievietot to mutē.

Medicīniskā aprīkojuma lietošanas gadījumā pirms ierīces lietošanas sākšanas sazinieties ar tā ražotāju, lai noskaidrotu, vai radiofrekvence, ko emitē ierīce, ietekmē medicīniskās iekārtas darbību.

Ierīces emitētās radiofrekvences var traucēt dažu dzirdes aparātu darbību.

Pirms viedaprocē lietošanas sākšanas sazinieties ar Jūsu dzirdes aparāta ražotāju.

Daļas nosaukums	Toksiskas un bīstamas ierīces un elementi					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE
Plastmasas korpuss	0	0	0	0	0	0
Shēmas modulis	X	0	0	0	0	0
Baterija	X	0	0	0	0	0
Citas daļas	0	0	0	0	0	0

0: Norāda, ka toksisku un bīstamu vielu saturs viendabīgā daļas materiālā ir zemāka par standartā sj/t11363-2006 "prasības attiecībā uz noteiktu toksisku un bīstamu vielu maksimālo koncentrāciju elektroniskās informācijas izstrādājumos" noteikto robežvērtību.

X: Norāda, ka toksisku un bīstamu vielu saturs vismaz vienā viendabīgā daļas materiālā pārsniedz standartā sj/t11363-2006 noteikto robežvērtību. Virzieni 1. vienplates/shēmas moduļu ierīces ietver svīnu vara sakausējumus vai augsttemperatūras lodmetālā. 2. baterijas ķēde ar pb



CE RoHS

Attiecas uz skaitītāju

Pārsvītrotā atkritumu groza simbols, norādīts uz produkta nozīmē, ka nolietotas elektriskās un elektroniskās ierīces aizliegts izmest kopā ar citiem atkritumiem. Saskaņā ar EEIA direktīvu par nolietotu elektrisko un elektronisko iekārtu apsaimniekošanu, šai ierīcei ir piemērojama selektīva savākšana. Lietotājam, kurš grib likvidēt šo produktu ir pienākums nodot nolietotās elektriskās un elektroniskās ierīces nolietoto ierīču pieņemšanas punktā, kas veicina atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, un apkārtējās vides aizsardzību. Šim mērķim, jāsaazinās ar produkta pārdevēju, vai vietējās valdības pārstāvjiem. Elektroniskajā ierīcē esošas bīstamas sastāvdaļas var negatīvi un ilgstoši iedarboties uz apkārtējo vidi un cilvēku dzīvību.

BEMERKUNG Vorliegende bedienungsanleitung auf später aufbewahren. Produkt Geeignet ausschliesslich für Hausgebrauch.

SMARTBAND


HOW TO CHARGE

Befestigen Sie den Ladeanschluss am Ladepunkt des Bandes.
Schließen Sie das andere Ende des Ladekabels an den USB-Stecker oder an den USB-Anschluss Ihres Computers an.
Das Armband zeigt das Ladesymbol, was bedeutet, dass der Akku geladen wird.

- 1) USB Ladeanschluss
- 2) Laden
- 3) Vollständig geladen

EIN LAUFBAND, DAS IHRE HERZFREQUENZ STEUERT / HERZFREQUENZMESSUNG

Bei Verbindung mit Gfit wird die Geschwindigkeit automatisch an Ihre Herzfrequenz angepasst. Geben Sie die Herzfrequenz-Schnittstelle ein, bewegen Sie Ihren Arm nicht und das Band wird Ihre Herzfrequenz anzeigen.

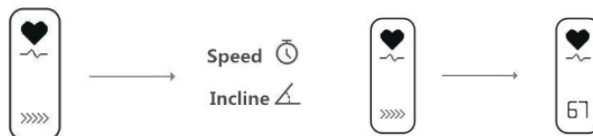

SCHRITTMESSUNG / ZEITMODUL BILDER –

Klicken Sie auf die Drucktaste, um die Anzahl der Schritte anzuzeigen. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, heben Sie den Handgelenk und die Uhrzeit wird angezeigt.



FAQ

Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth Ihres Telefons aktiviert ist und dass das Telefon mit Android 4.4 oder höher, iOS 8.0 oder höher und Bluetooth 4.0 oder höher ausgestattet ist.

1. Wie reinigen Sie das Armband? Wie reinigen Sie den Kontaktpunkt?

- a) Das Armband kann mit einem feuchten oder trockenen und weichen Tuch abgewischt werden (keine scharfen Lösungsmittel verwenden).
- b) Der Ladekontaktpunkt kann mit einem trockenen Tuch abgewischt werden. Stellen Sie sicher, dass der Ladekontaktpunkt trocken ist.

2. Kann ich beim Händewaschen / Duschen beim Schwimmen das Armband tragen?

- a) Das Armband ist wasserdicht und kann beim Händewaschen getragen werden.
- b) Das Armband darf sich nicht lange im Wasser, in der Sauna, im Dampfbad oder im Bad befinden.

WARUNG

Zerlegen, modifizieren oder reparieren Sie das Band nicht, drücken oder legen Sie die Batterie nicht an Orten ab, an denen die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, da dies eine Explosion oder einen Brand verursachen kann.

- Wenn Sie beim Tragen dieses Armbandes Hautreizungen, Juckreiz und ähnliche Nebenwirkungen spüren, ziehen Sie es sofort aus und suchen Sie einen Arzt auf.

• Tragen Sie keine Farbe auf das Gerät auf und kleben Sie kein Papier darauf, da sonst Teile des Geräts verkleben und eine normale Verwendung nicht möglich ist.

• Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden, da sonst das Gerät beschädigt werden kann und die Herstellergarantie keine Reparaturen durch nicht qualifiziertes Personal abdeckt..

ACHTUNG

Zubehör und verwandte Produkte.

Das Gerät darf keinen Stößen ausgesetzt werden, da dies zu Beschädigungen führen kann.

Lassen Sie das Band nicht an überhitzten oder zu kalten Orten liegen. Die empfohlene Temperatur beträgt 0 °C - 40 °C

Das Band darf sich nicht in oder in der Nähe der Heizkörper befinden.

Mikrowellenherde, Kochgeräte oder Hochdrucktanks.

- Lassen Sie Kinder oder Tiere das Gerät nicht kauen oder verschlucken.
- Um Störungen des Herzschrittmachers so gering wie möglich zu halten, tragen Sie das Gerät auf der gegenüberliegenden Seite des Herzschrittmachers.
- Wenn das Gerät mit einem Blitz oder einer Lampe ausgestattet ist, verwenden Sie es nicht in der Nähe von menschlichen oder tierischen Augen.

• Stoßen Sie das Gerät nicht gegen Augen, Ohren oder andere Körperteile und legen Sie es nicht in den Mund.

• Wenn Sie medizinische Geräte verwenden, wenden Sie sich bitte an den Hersteller der medizinischen Geräte, bevor Sie das Armband verwenden, um festzustellen, ob die vom Band ausgesendete Funkfrequenz das medizinische Gerät beeinträchtigt.

• Die von diesem Armband ausgestrahlten Funkfrequenzen können einige Hörgeräte stören. Vor der Verwendung dieses Geräts wenden Sie sich an den Hersteller, um festzustellen, ob dies die Funkfrequenz dieses Geräts beeinträchtigt, bevor Sie dieses Armband verwenden.

Name des Teils	Giftige und gefährliche Stoffe oder Elemente					
	Pb	Hg	Cd	Cr ⁺⁶	PBB	PBDE
Plastik Gehäuse	0	0	0	0	0	0
Schaltkreis Modul	X	0	0	0	0	0
Batterie	X	0	0	0	0	0
Andere Teile	0	0	0	0	0	0

0: Zeigt an, dass der Gehalt an giftigen und gefährlichen Stoffen im homogenen Material der Teile unter der Grenzwertanforderung Si / T11363-2006 "Anforderungen an Beschränkungen für giftige und gefährliche Stoffe in elektronischen Informationsprodukten" liegt.

X Zeigt an, dass der Gehalt an giftigen und gefährlichen Stoffen in mindestens einem homogenen Material des Teils die Grenzwertanforderung 52 / T11363-2006 überschreitet.

Richtungen:

1. Single Deck Geräte / Peripheriegeräte enthalten Blei in Kupferlegierungen oder Hochtemperatur-Lua.
2. Batteriekreis mit Blei



Betrifft Zählwerk

Die Bezeichnung des Gerätes mit dem Symbol der durchgestrichenen Mülltonne informiert über Verbot der Entsorgung der ausgedienten Elektro- und Elektronikgeräten mit sonstigen Abfällen. Gemäß der WEEE Richtlinie zum Umgang mit Elektronikschrott, sind diese Geräte anderweitig zu entsorgen. Verbraucher dürfen ausgediente Elektrogeräte nun nicht mehr in den Hausmüll werfen, sondern müssen diese an speziellen Sammelstellen abgeben. Zu diesem Zweck soll der Verbraucher sich an die Stelle wenden, wo das Gerät erworben wurde, bzw. an Vertreter der örtlichen Behörden. Gefährliche Inhalte der Elektronikgeräte können lang anhaltende ungünstige Änderungen in natürlicher Umgebung verursachen, wie auch die Gesundheit der Menschen beeinträchtigen.

SPOKEY

Spokey sp. z o.o.

al. Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice

tel: +48 32 317 20 00,

www.spokey.pl / www.spokey.eu

e-mail: biuro@spokey.pl / office@spokey.eu

DISTRIBUTOR:

Spokey s.r.o., Sadová 618, 738 01 Frýdek - Místek

Česká republika, www.spokey.cz

Kanlux s.r.o., M. R. Štefánika 379/19, 911 01 Trenčín,

Slovensko, www.spokey.eu